

SDI

WAVE WAVE MV WAVE HV

COMPOSITE FLOW A HAUTE TENEUR EN FLUOR




3 VISCOSITÉS:
FLUIDE,
MOYENNE ET
HAUTE

UN COMPOSITE FLUIDE POLYVALENT

Wave, Wave MV et Wave HV sont des composites fluides polyvalents, radio-opaques, photopolymérisables et qui relarguent du fluor conçus pour les restaurations antérieures et postérieures. Wave est un composite extrêmement fluide. Wave MV est un composite fluide de moyenne viscosité. Wave HV est un composite de haute viscosité qui ne coule pas.

CHOIX ENTRE 3 VISCOSITÉS

La large gamme de viscosités offerte par Wave offre au clinicien le choix dont il aura besoin dans tous les cas cliniques.

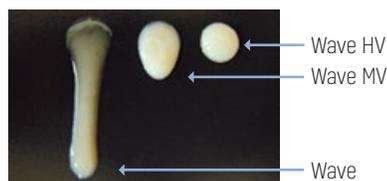

Flux à angle droit pour 2 minutes

SDI Flow	Semblable à
Wave	UltraSeal XT Plus*
	Premise Flowable*
	Filtek Supreme Plus Flowable*
Wave MV	Heliomolar Flow*
	Tetric Flow*
	Revolution Formula 2*
	Flow-It! ALC*
	Point 4 Flowable*
Wave HV	Filtek Flow*
	AeliteFlo LV*
	Esthet-X Flow*
	AeliteFlo*


* N'est pas une marque déposée de SDI Limited

13
TEINTES



LIBÉRATION DE FLUOR

L'effet cariostatique du fluor améliore la reminéralisation et inhibe la déminéralisation de l'émail. En milieu aqueux, les ions fluorures de Wave, Wave MV et Wave HV issus de la résine se diffusent dans la dent. Ce mouvement ionique est causé par un fluide oral qui traverse la résine et la dent dans les deux sens, transportant ainsi les ions fluorures.

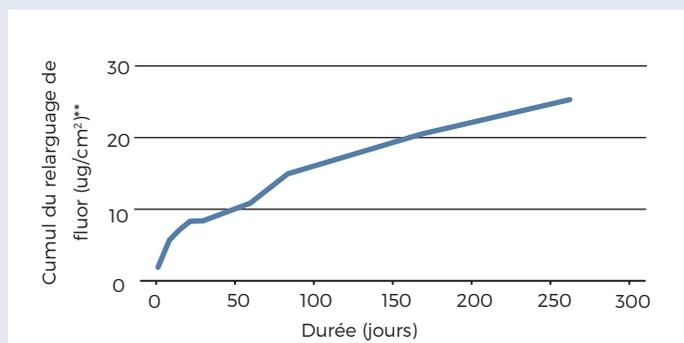


** Source: Attar, N. and Turgut, MD. [2003] 'Fluoride Release and Uptake Capacities of Fluoride-Releasing Restorative Materials', Operative Dentistry, 28(4), pp. 395-402.

RESISTANCE A LA COMPRESSION ELEVEE

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

Résistance à la compression élevée de Wave, Wave MV et Wave HV permet leur utilisation dans de nombreuses applications.

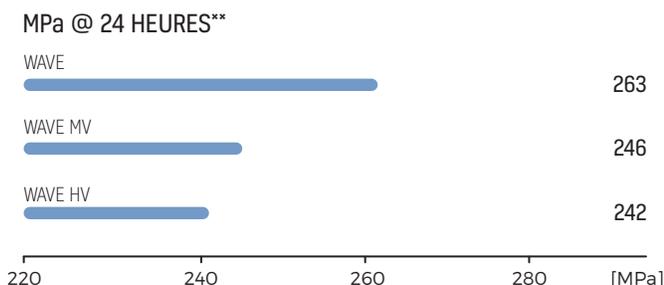

** Source : données issues de tests SDI

AVANTAGES

Haute résistance à la compression

Trois viscosités

Fluorescence naturelle



LARGE GAMME DE TEINTES

La gamme Wave 13 teintes de Wave couvrent toutes les restaurations antérieures et postérieures : A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, C3, D3, OA2, gingival et bleach. La teinte « Gingival » est indiquée pour les restaurations cervicales chez les patients âgés. Il existe une teinte "Bleach" pour les des dents dont la teinte est plus claire que B1.

CHARGES

Wave, Wave MV et Wave HV contiennent des nanoparticules traitées afin de maximiser le polissage, la résistance à l'usure et la solidité, ce qui facilite l'extrusion.

RADIO-OPACITÉ

Wave, Wave MV et Wave HV sont radio-opaques, ce qui permet une identification facile de caries secondaires à l'interface.

FLUORESCENCE NATURELLE

Wave, Wave MV et Wave HV contiennent un agent fluorescent grâce auquel les dents paraissent naturelles sous les rayons ultraviolets. Personne ne saura!



Wave sur les dents naturelles sous lumière UV

INSTRUCTIONS

- 1** Laver et isoler la dent.
- 2** Sécher sans assécher. Garder humide si possible, mais une surface sèche ne posera pas non plus de problème.
- 3** Appliquer un système adhésif tel que Zipbond (SDI Limited)* afin d'impregner toutes les surfaces internes.
- 4** Sécher soigneusement avec un jet d'air sec et sans huile. S'assurer que la surface est brillante.
- 5** Photopolymériser en respectant les instructions du fabricant du système adhésif.
- 6** Injecter Wave, Wave MV ou Wave HV directement par incréments de 2 mm ou moins dans:
 - 6.1** Les restaurations de classe V, ou
 - 6.2** Les préparations en tunnel, ou
 - 6.3** Les scellements des puits ou fissures, ou
 - 6.4** Les restaurations minimales de classe I, II, III et IV, ou les autres indications selon
- 7** Photopolymériser le composite à l'aide d'une lampe à polymériser LED à haute intensité (440-480nm) avec une puissance minimum de 500mW/cm², telle que Radii Xpert (SDI Limited), en incréments de 2 mm.
- 8** Polissage et finissage.

*Conformément aux instructions du fabricant du système adhésif.

GAMME DISPONIBLE



SERINGUES

Recharges de seringues

1 x 1g seringue
5 embouts jetables à usage unique

	WAVE	WAVE MV	WAVE HV
A1	7510102	8310102	8210102
A2	7510203	8310203	8210203
A3	7510304	8310304	8210304
A3.5	7510405	8310405	8210405
B1	7511101	8311101	8211101
B2	7511211		
B3	7511314		
C2	7512223		
C3	7512324		
D3	7513334		
OA2	7510204		
Incisal	7514142		
Gingival (A5)	7514143		
Bleach	7514147		

EMBOUTS

Embouts jetables pour seringues Wave

20 x embouts jetables à usage unique (calibre 20)	7500001
200 x embouts jetables à usage unique (calibre 200)	8100062

Embouts jetables pour seringues Wave MV et HV

20 x embouts jetable à usage unique (calibre 18)	8100065
--	---------

KITS

Kit d'introduction seringue Wave

4 x seringues de 1g A2, B3, C3, OA2 20 x embouts jetables à usage unique	7500000
---	---------

Bulk kit seringue Wave

10 x seringues de 1g
40 x embouts jetables à usage unique

A1	7500011
A2	7500012
A3	7500013

* Ceci n'est pas une marque déposée SDI

** Tests et données internes publiés par SDI



YOUR SMILE. OUR VISION.



11-2024

M100632 D



+D036M1006321-

FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
par SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIE 1800 337 003
AUTRICHE 00800 0225 5734
BRÉSIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759

ITALIE 00800 0225 5734
NOUVELLE ZÉLANDE 0800 808 855
ESPAGNE 00800 0225 5734
ROYAUME-UNI 00800 0225 5734
ÉTATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166